

عنوان آزمایش : CA 19-9

عنوان دستگاه : ABBBOTT سری ساخت : 34312201

عنوان کنترل :

multichem I

شروع کنترل : 1400/09/18


3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
47.001	43.384	39.767	36.15	32.533	28.916	25.299	3.617	8.5

تاریخ	مقدار
30/09/1400	36.07
01/10/1400	38.4
02/10/1400	37.4
04/10/1400	39.7

تاریخ	مقدار
24/09/1400	39.6
25/09/1400	37
27/09/1400	36.8
28/09/1400	35
29/09/1400	35.9

تاریخ	مقدار
18/09/1400	35.7
20/09/1400	37.2
21/09/1400	36.8
22/09/1400	37.01
23/09/1400	37.5

Mean: 37.149	SD: 1.359	CV%: 3.657
--------------	-----------	------------

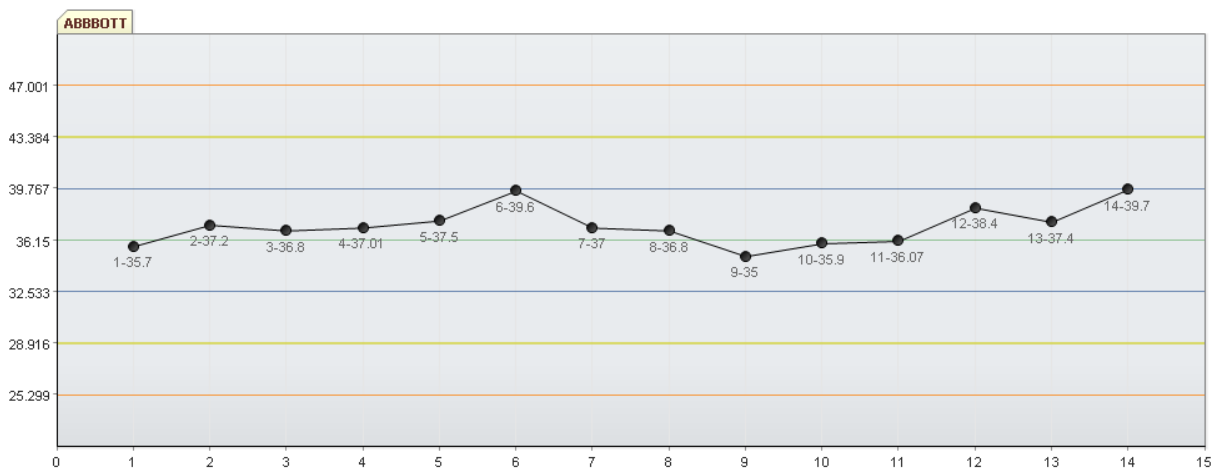

عنوان آزمایش : CA 19-9

عنوان دستگاه : ABBOTT سری ساخت : 34312203

عنوان کنترل :

Multichem II

شروع کنترل : 1400/09/18

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
144.001	136.034	128.067	120.1	112.133	104.166	96.199	7.967	8.4

تاریخ	مقدار
30/09/1400	125.8
01/10/1400	119.3
02/10/1400	123.5
04/10/1400	135

تاریخ	مقدار
24/09/1400	128.3
25/09/1400	114.3
27/09/1400	126.5
28/09/1400	124
29/09/1400	123

تاریخ	مقدار
18/09/1400	118.5
20/09/1400	123
21/09/1400	111.9
22/09/1400	124.5
23/09/1400	128.2

Mean: 123.271	SD: 5.913	CV%: 4.797
---------------	-----------	------------

