

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۱۱:

سری ساخت : FN00۱۴۱۹۴

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۵۵۴	۰.۲۷۳	۱.۳۵۴	۱.۶۲۷	۱.۹	۲.۱۷۳	۲.۴۴۶	۲.۷۱۹	۲.۹۹۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲.۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۲.۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۲.۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲.۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۲.۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲.۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۲.۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۲.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۲.۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۲.۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲.۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۲.۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲.۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

CV%: 8.473	SD: 0.206	Mean: 2.437
------------	-----------	-------------

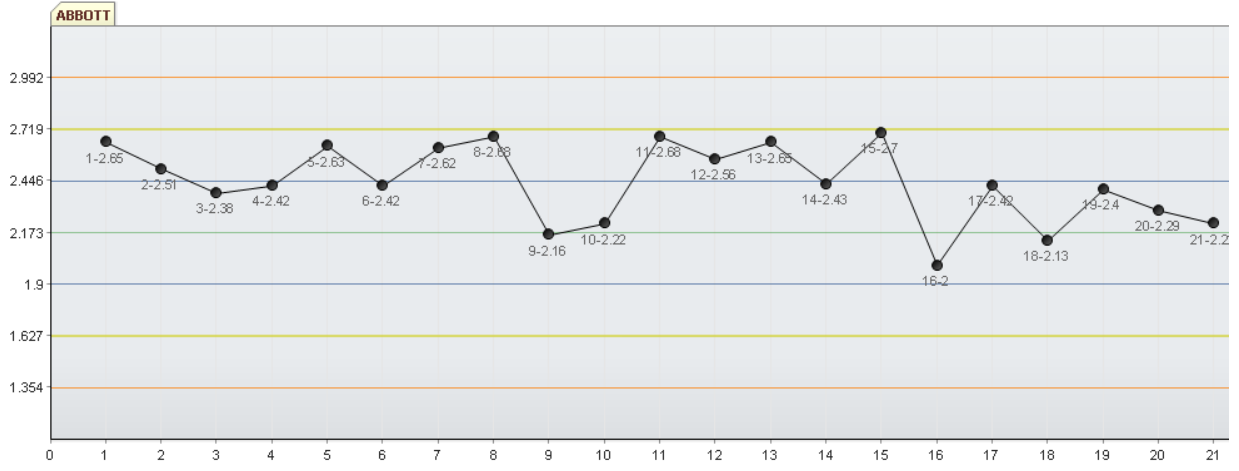

22