

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : 34312201

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل : 1400/09/18


3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.274	0.253	0.232	0.211	0.19	0.169	0.148	0.021	4.7

تاریخ	مقدار
30/09/1400	0.201
01/10/1400	0.178
02/10/1400	0.181
04/10/1400	0.186

تاریخ	مقدار
24/09/1400	0.186
25/09/1400	0.218
27/09/1400	0.186
28/09/1400	0.195
29/09/1400	0.188

تاریخ	مقدار
18/09/1400	0.196
20/09/1400	0.187
21/09/1400	0.201
22/09/1400	0.186
23/09/1400	0.2

Mean: 0.192	SD: 0.01	CV%: 5.458
-------------	----------	------------

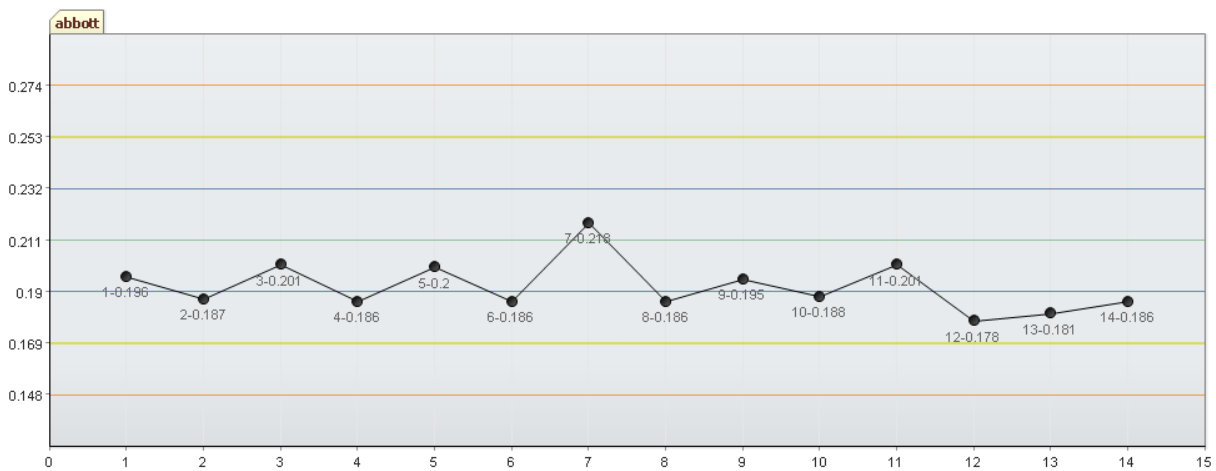

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : 34312203

عنوان کنترل : abbot-III
شروع کنترل : 1400/09/18

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
15.099	14.266	13.433	12.6	11.767	10.934	10.101	0.833	4.7

تاریخ	مقدار
30/09/1400	12.2
01/10/1400	12.5
02/10/1400	11.9
04/10/1400	12.7

تاریخ	مقدار
24/09/1400	12.8
25/09/1400	12.4
27/09/1400	12.9
28/09/1400	13.1
29/09/1400	12

تاریخ	مقدار
18/09/1400	12.7
20/09/1400	12.3
21/09/1400	12.1
22/09/1400	12.4
23/09/1400	12.2

Mean: 12.443	SD: 0.357	CV%: 2.867
--------------	-----------	------------

