

عنوان کنترل : کنترل II
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۱۲/۲۳:

سری ساخت : ۱۰۴۵۵۷

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : IDS


%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۶	۰.۳۹۷	۴.۷۶۹	۵.۱۶۶	۵.۵۶۳	۵.۹۶	۶.۳۵۷	۶.۷۵۴	۷.۱۵۱

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۵.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵

CV%: 8.57	SD: 0.496	Mean: 5.783
-----------	-----------	-------------

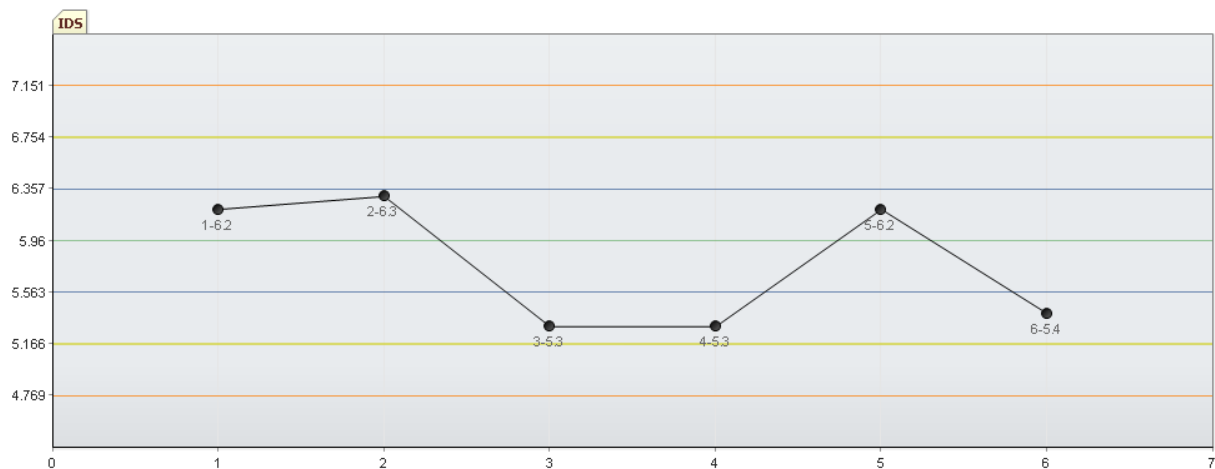

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۳:

سری ساخت : ۱۰۴۵۵۷

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۴	۰.۱۱۳	۰.۷۸۱	۰.۸۹۴	۱.۰۰۷	۱.۱۲	۱.۲۳۳	۱.۳۴۶	۱.۴۵۹

مقدار	تاریخ
۱.۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

CV%: 11.601	SD: 0.137	Mean: 1.177
-------------	-----------	-------------

