

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : LH  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۷۹	۰,۰۷۱	۳,۷۳۷	۳,۸۰۸	۳,۸۷۹	۳,۹۵	۴,۰۲۱	۴,۰۹۲	۴,۱۶۳

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳,۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۳,۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۴,۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴,۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳,۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴,۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲

CV%: 2.066	SD: 0.082	Mean: 3.949
------------	-----------	-------------

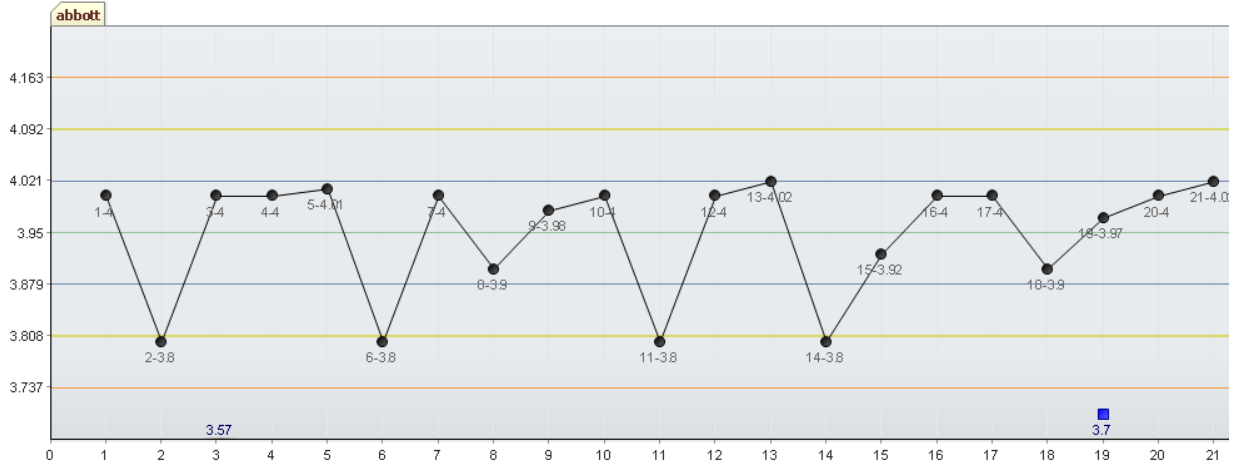

22