

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


%CV	SD	SD _۲ -	SD _۳ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۶.۰۱۲	۰.۴۰۶	۵.۵۳۲	۵.۹۳۸	۶.۳۴۴	۶.۷۵	۷.۱۵۶	۷.۵۶۲	۷.۹۶۸

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۶.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۷.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۶.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۶.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۶.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۶.۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶.۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۷.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۷.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۶.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶.۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۶.۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۶.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 7.411	SD: 0.486	Mean: 6.562
------------	-----------	-------------

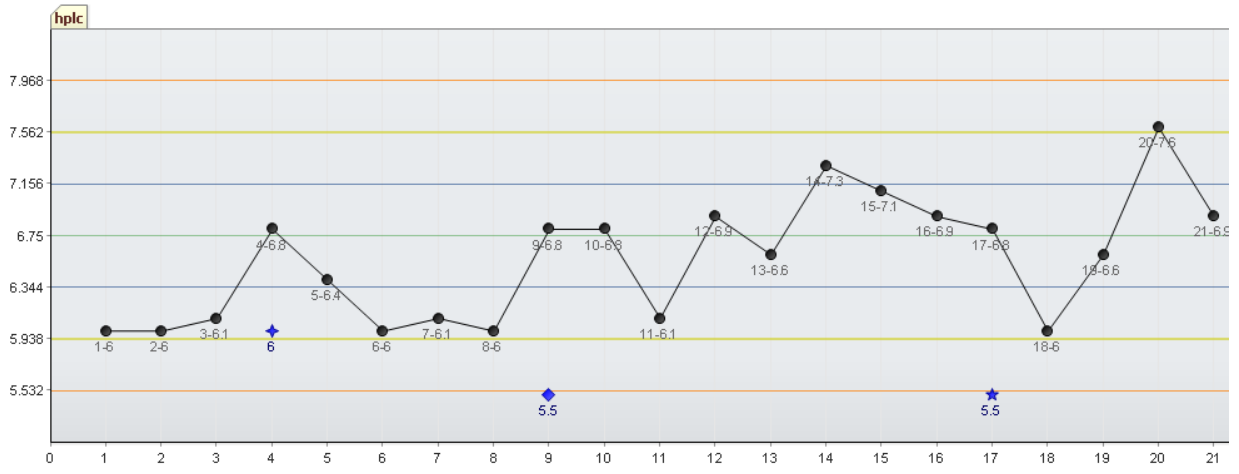

22