

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
عنوان کنترل : پولد سرم


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۳۵۱	۱.۸۹۳	۲۴.۱۳۴	۲۶.۰۳۷	۲۷.۹۳	۲۹.۸۱۳	۳۱.۷۰۶	۳۳.۵۹۹	۳۵.۴۹۲

مقدار	تاریخ
۲۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۸.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۱.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۲.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۹.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۹.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۳۱.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۲.۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۹.۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۱.۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۹.۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 6.629	SD: 1.99	Mean: 30.024
------------	----------	--------------

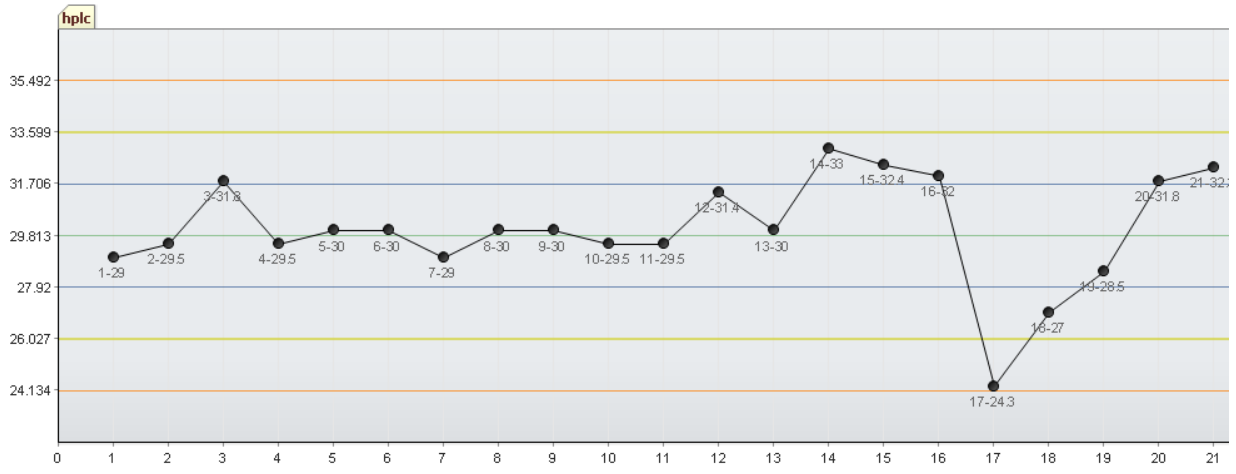

22