

con-II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۰۶:

سری ساخت : FN00۲۶۳۹۳

Rubella Ab (IgG)-CLIA : عنوان آزمایش :
Abbot : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷	۱۰	۱۸۰	۱۹۰	۲۰۰	۲۱۰	۲۲۰	۲۳۰	۲۴۰

مقدار	تاریخ
۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۲۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵

CV%: 3.649	SD: 8.068	Mean: 221.095
------------	-----------	---------------

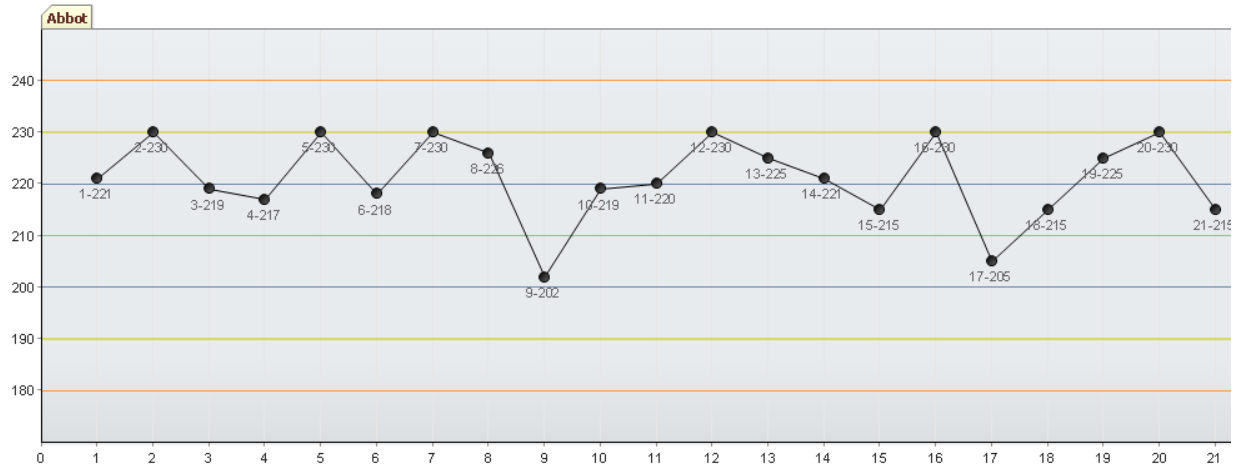

22