

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲۱.۸۷۵	۰.۰۶۸	۰.۱۰۸	۰.۱۷۶	۰.۳۱۲	۰.۲۸	۰.۴۴۸	۰.۵۱۶

مقدار	تاریخ
۰.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۰.۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۰.۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۰.۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۰.۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۰.۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۰.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۰.۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۰.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۰.۴۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۰.۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۰.۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۰.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۰.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۰.۴۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۰.۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۰.۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲

CV%: 17.92	SD: 0.068	Mean: 0.378
------------	-----------	-------------

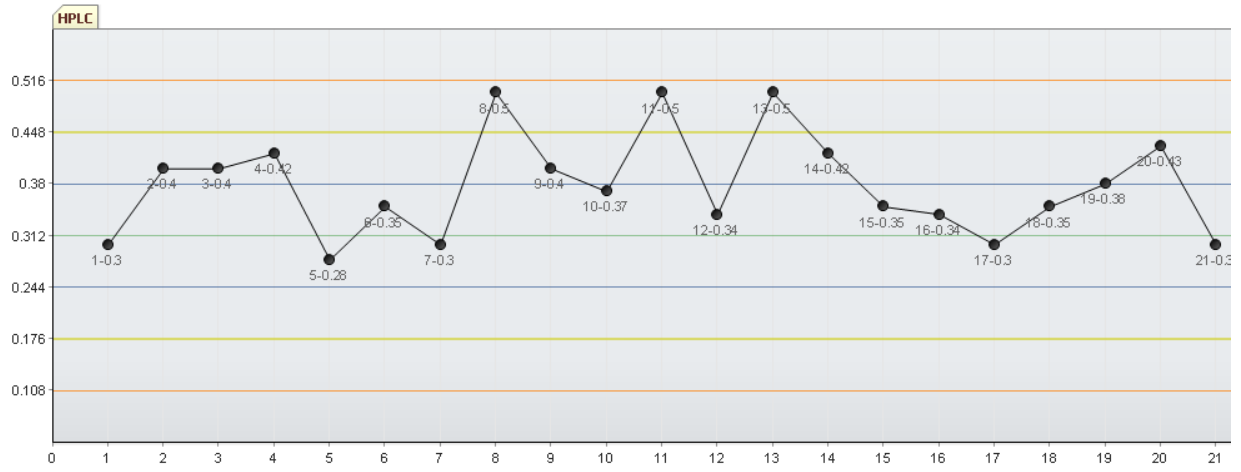

22