

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : *
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۷۸۵	۰.۰۲۹	۰.۴۰۸	۰.۴۳۷	۰.۴۶۶	۰.۴۹۵	۰.۵۲۴	۰.۵۵۳	۰.۵۸۲

مقدار	تاریخ
۰.۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۰.۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۰.۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۰.۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۰.۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۰.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۰.۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۰.۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۰.۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۰.۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۰.۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 6.825	SD: 0.032	Mean: 0.473
------------	-----------	-------------

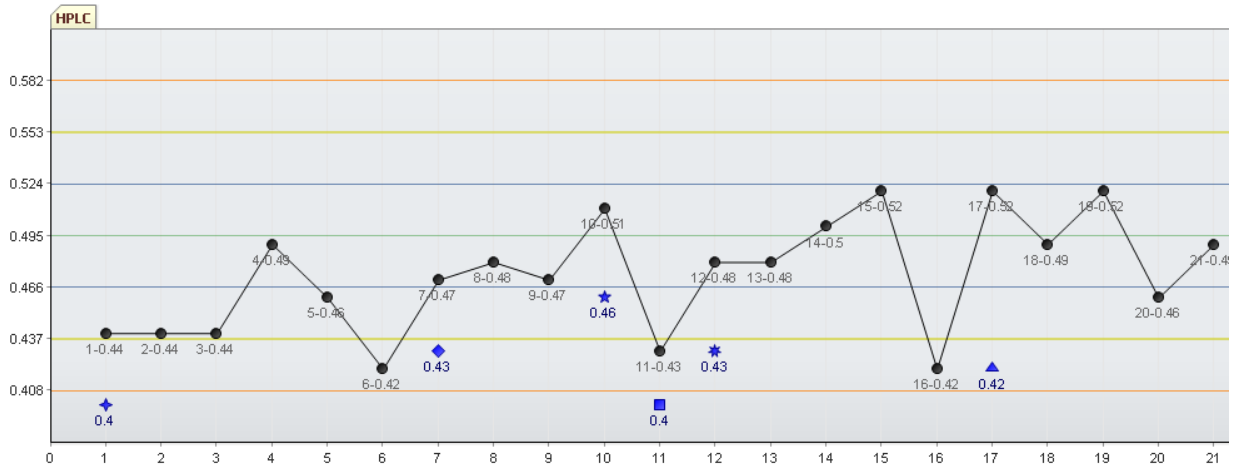

22