

عنوان کنترل : کنترل ۱  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۰-۲۵۳-۱۰/


عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۹۸۸	۱.۲۵	۱۰.۱۶	۱۱.۴۱	۱۲.۶۶	۱۳.۹۱	۱۵.۱۶	۱۶.۴۱	۱۷.۶۶

مقدار		تاریخ	
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۵.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳

CV%: 2.303	SD: 0.354	Mean: 15.35
------------	-----------	-------------

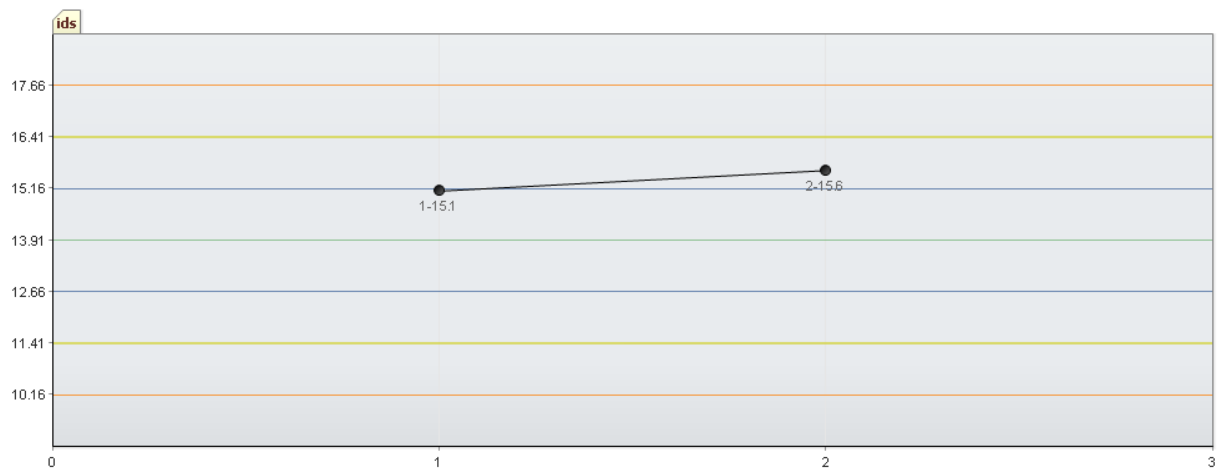

عنوان کنترل : permium plus  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۲/۱۷:

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : لیازون  
سری ساخت : ۲۱۲۴

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۷.۷۲	۱.۸	۱۷.۹۱۷	۱۹.۷۱۷	۲۳.۳۱۷	۲۵.۱۱۷	۲۶.۹۱۷	۲۸.۷۱۷

مقدار	تاریخ
۲۲.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۳.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۳.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۷

مقدار	تاریخ
۲۴.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۲۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴

CV%: 8.291	SD: 1.924	Mean: 23.2
------------	-----------	------------

